



Universidad de  
**los Andes**



**FACULTAD  
DE ODONTOLOGÍA**

# RESTAURACIONES PROVISIONALES

- TÉCNICA DIRECTA CON LLAVE DE SILICONA
- TÉCNICA HÍBRIDA



Dra. Nicole Schlesinger P.  
Dr. Tomas Araya C.  
Dr. Gilbert Jorquera R.

**UNIVERSIDAD DE LOS ANDES**  
FACULTAD DE ODONTOLOGIA - AREA PRECLINICO INTEGRADO


Esta guía de procedimientos clínicos es de propiedad intelectual del área de Preclínico Integrado de la faculta de odontología de la Universidad de los Andes y se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización de sus autores y de la universidad. ©  
El derecho de autor esta protegido por el reglamento general de propiedad intelectual de la Universidad de los Andes. ©  
La utilización de imágenes de pacientes y procedimientos cuenta con la respectiva autorización firmada de los pacientes y los odontólogos que en ellos participaron.

**Autores:**

**Dr. Gilbert Jorquera Rivera**  
Cirujano Dentista – Especialista en Implantología Oral  
Docente Área Rehabilitación Oral  
Miembro de la Sociedad de Implantología Oral ( SIOCH )  
Profesor Asistente – Facultad de Odontología Universidad de los Andes

**Dra. Nicole Schlesinger Pupkin**  
Cirujano Dentista – Especialista en Rehabilitación Oral  
Docente Área Preclínico  
Diplomado en Pedagogía para la Educación Superior- Universidad Católica de Chile

**Dr. Tomas Araya Cereceda**  
Cirujano Dentista – Especialista en Rehabilitación Oral  
Docente Área Preclínico  
Profesor Asistente – Facultad de Odontología Universidad de los Andes

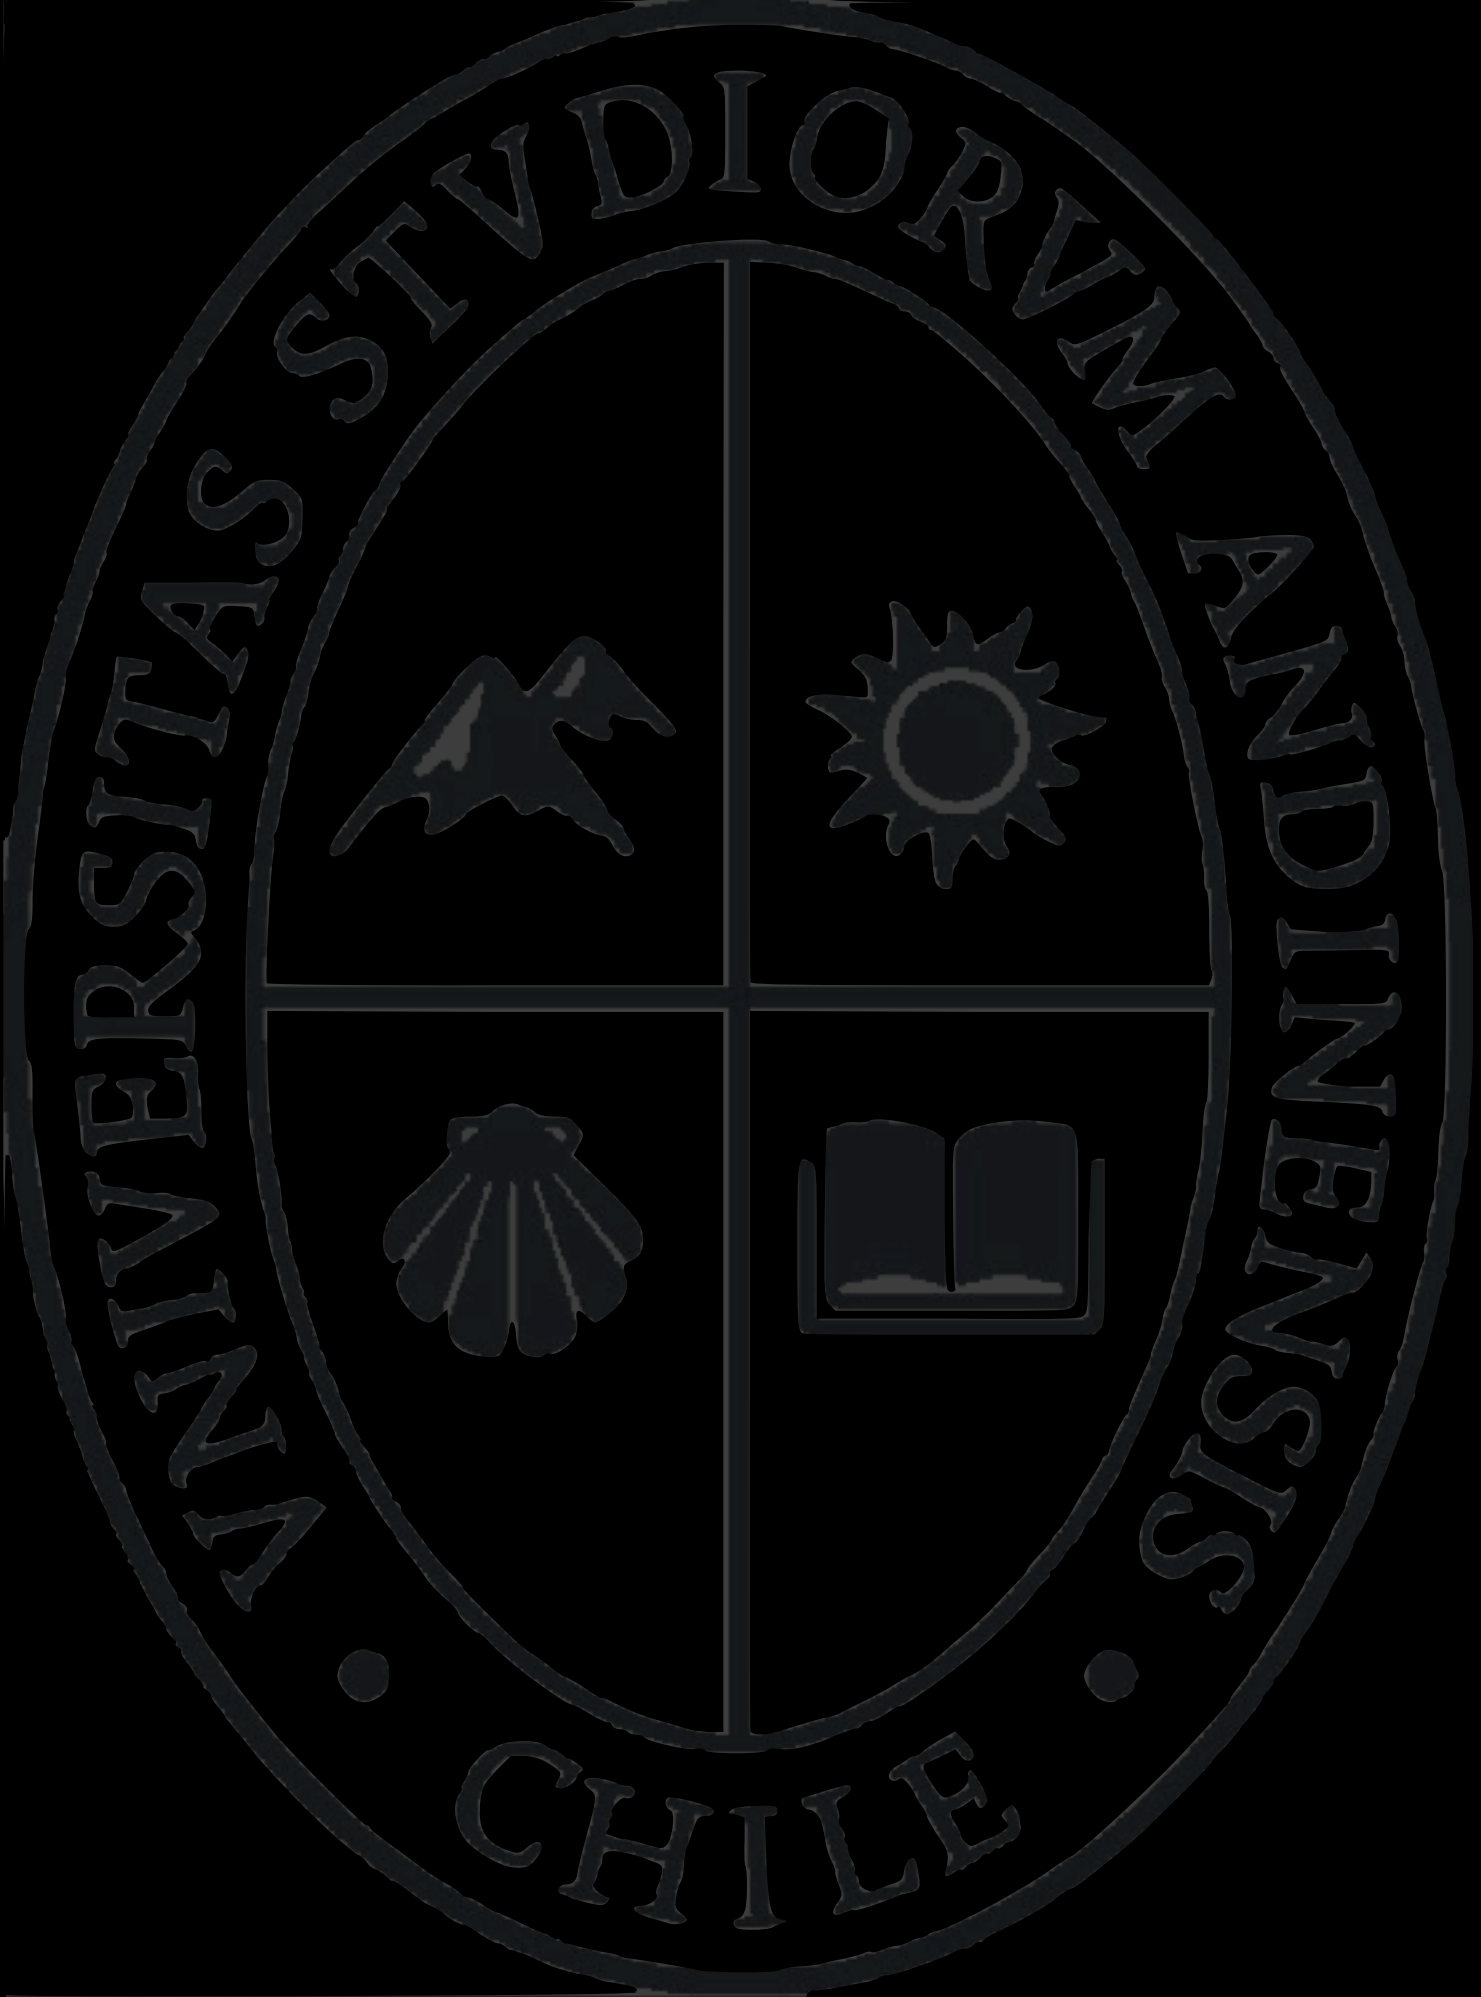



**Secuencia de tratamiento:**

**Provisorio de diente 1.3 con técnica directa con llave de silicona**

*Preclínico Integrado*



**Dra. Nicole Schlesinger P.**

**Dr. Tomas Araya C.**

**Dr. Gilbert Jorquera R.**



MATERIALES NECESARIOS



CE 0197

Kit Preclínico  
Universidad de los Andes  
REF TDXXXX

6801  
314  
012

6801  
314  
014

830L  
314  
010

959KR  
314  
018

368EF  
314  
021

Operatoria

H1  
204  
014

H1  
204  
016

**BRO.DENT**  
www.brodent.cl

6856  
314  
014

6368  
314  
023

8856  
314  
021

Prótesis Fija

859  
314  
010

811  
314  
033





APLIQUE VASELINA EN LA PREPARACIÓN BIOLÓGICA CON UNA MOTA DE ALGODÓN.







**PREPARE ACRÍLICO MARCHÉ DE AUTOPOLIMERIZACIÓN EN UN VASO DAPPEN Y LLÉVELO A LA LLAVE DE SILICONA EN ETAPA ARENOSA.**



**UNA VEZ QUE EL ACRÍLICO ESTÉ EN ETAPA PLÁSTICA, DEBE LLEVAR LA LLAVE DE SILICONA A POSICIÓN EN LA BOCA DEL PACIENTE.**










**UNA VEZ QUE EL ACRÍLICO ESTÉ EN ETAPA GOMOSA, RETIRE LA LLAVE DE SILICONA DE BOCA Y REMUEVA EL PROVISIONAL CON UNA PINZA, SIN DEFORMARLO.**



**INSERTE Y RETIRE EL PROVISIONAL EN LA PREPARACIÓN BIOLÓGICA REPETITIVAMENTE PARA EVITAR QUE SE RETENGA DEBIDO A LA CONTRACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN.**

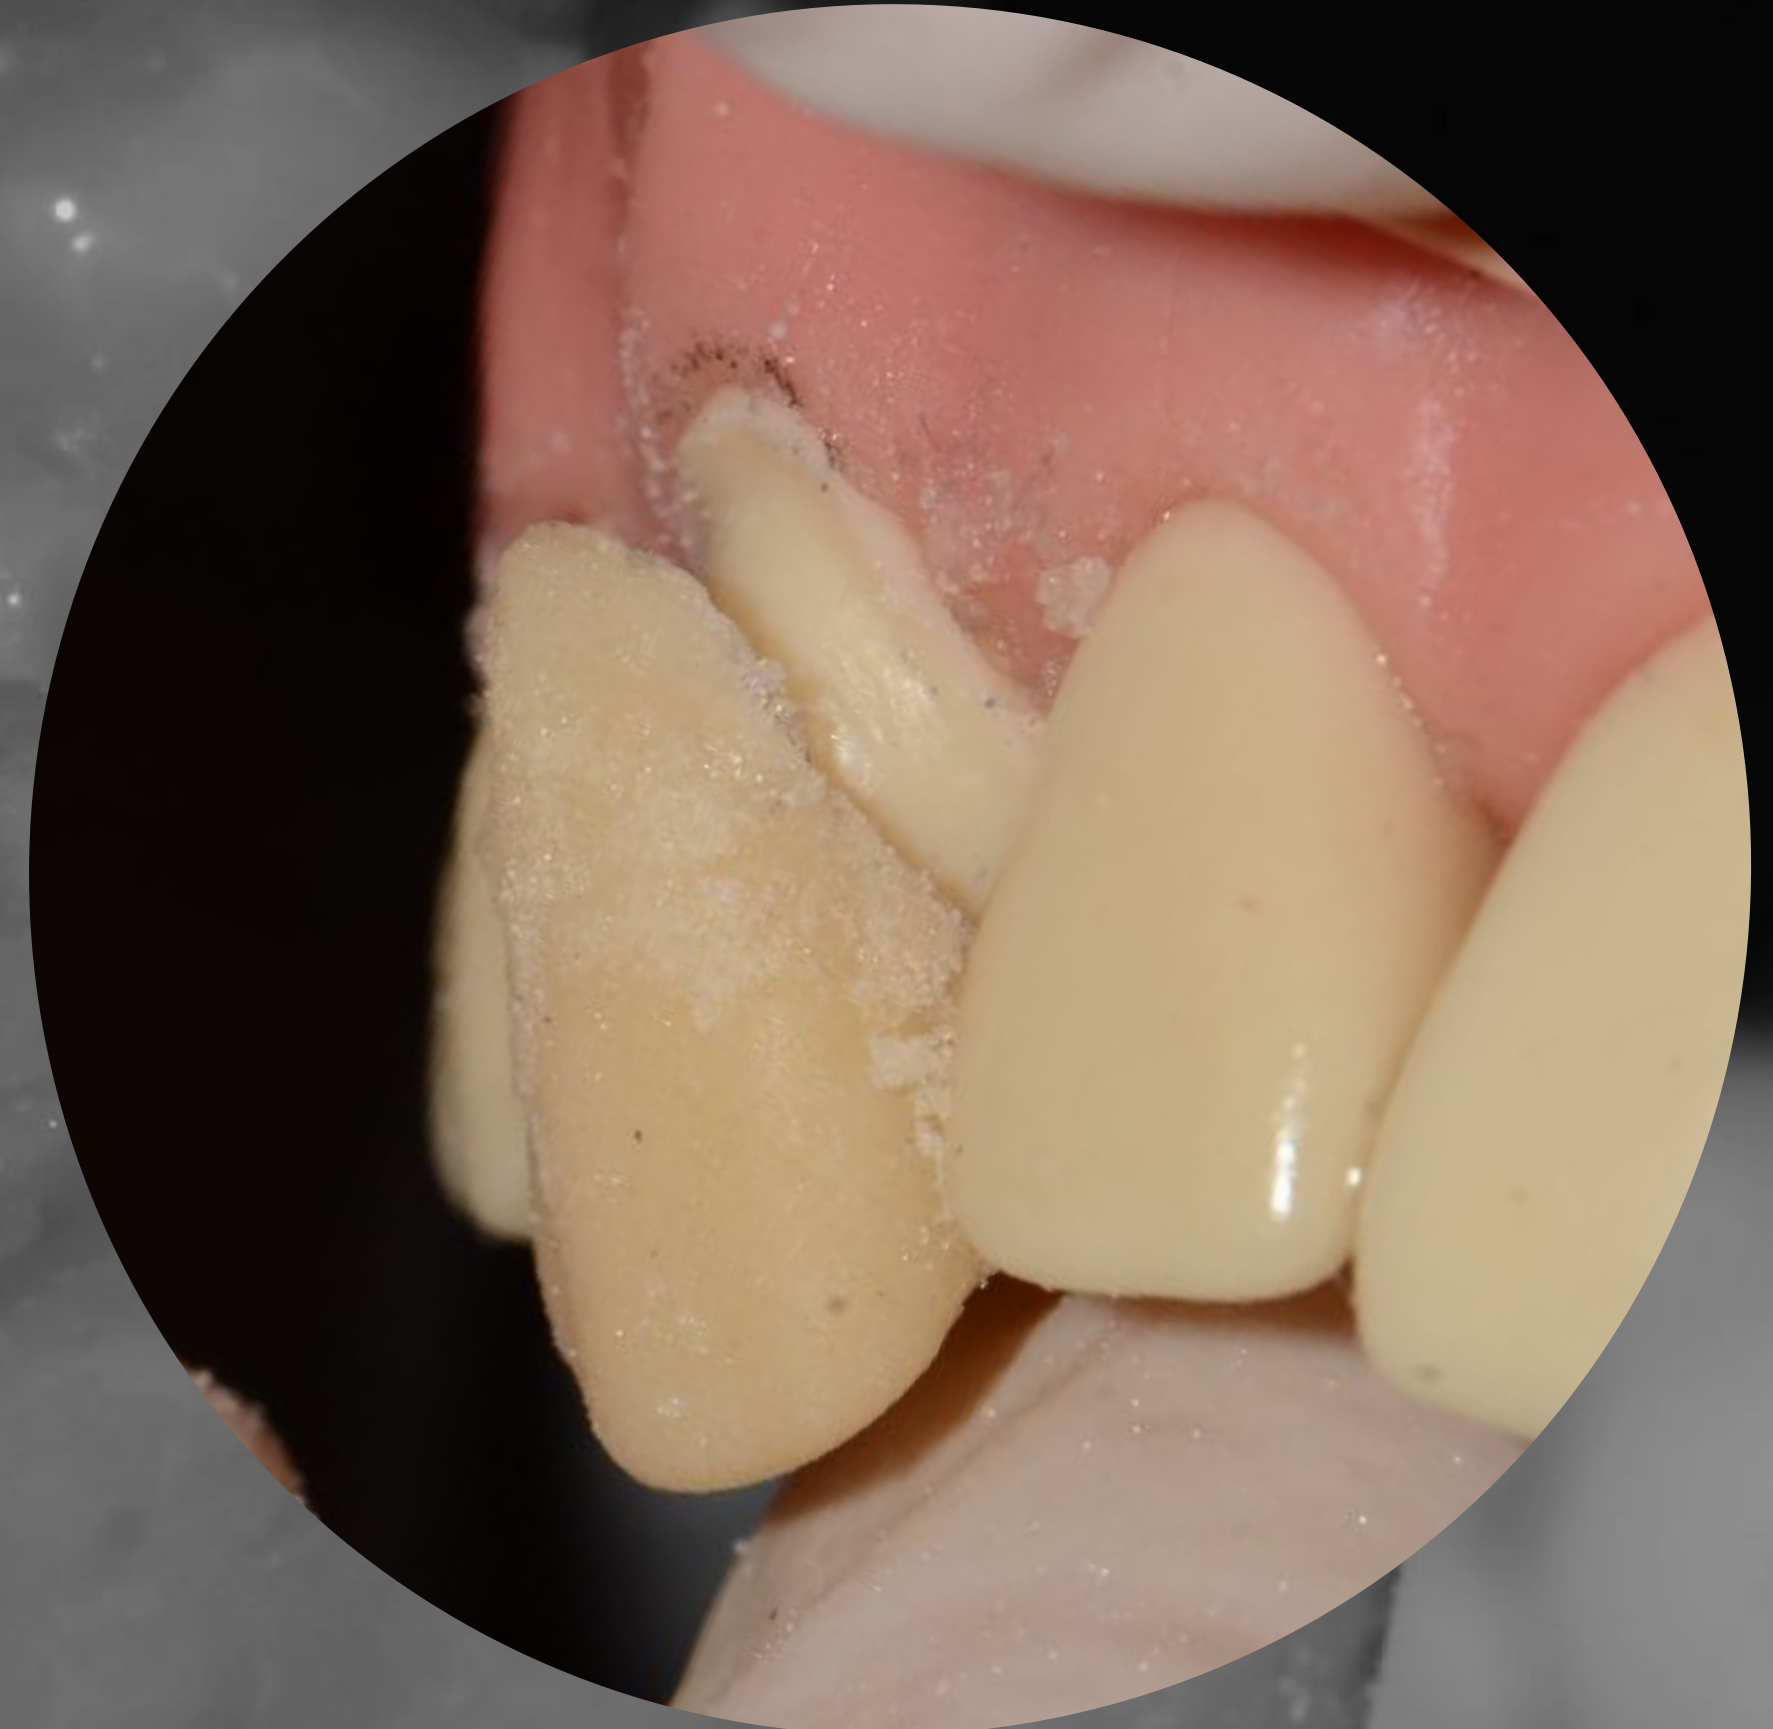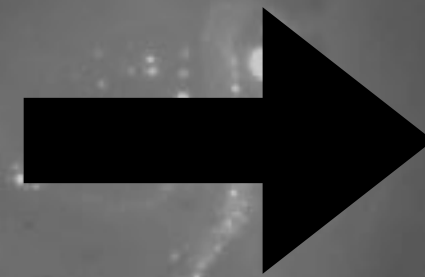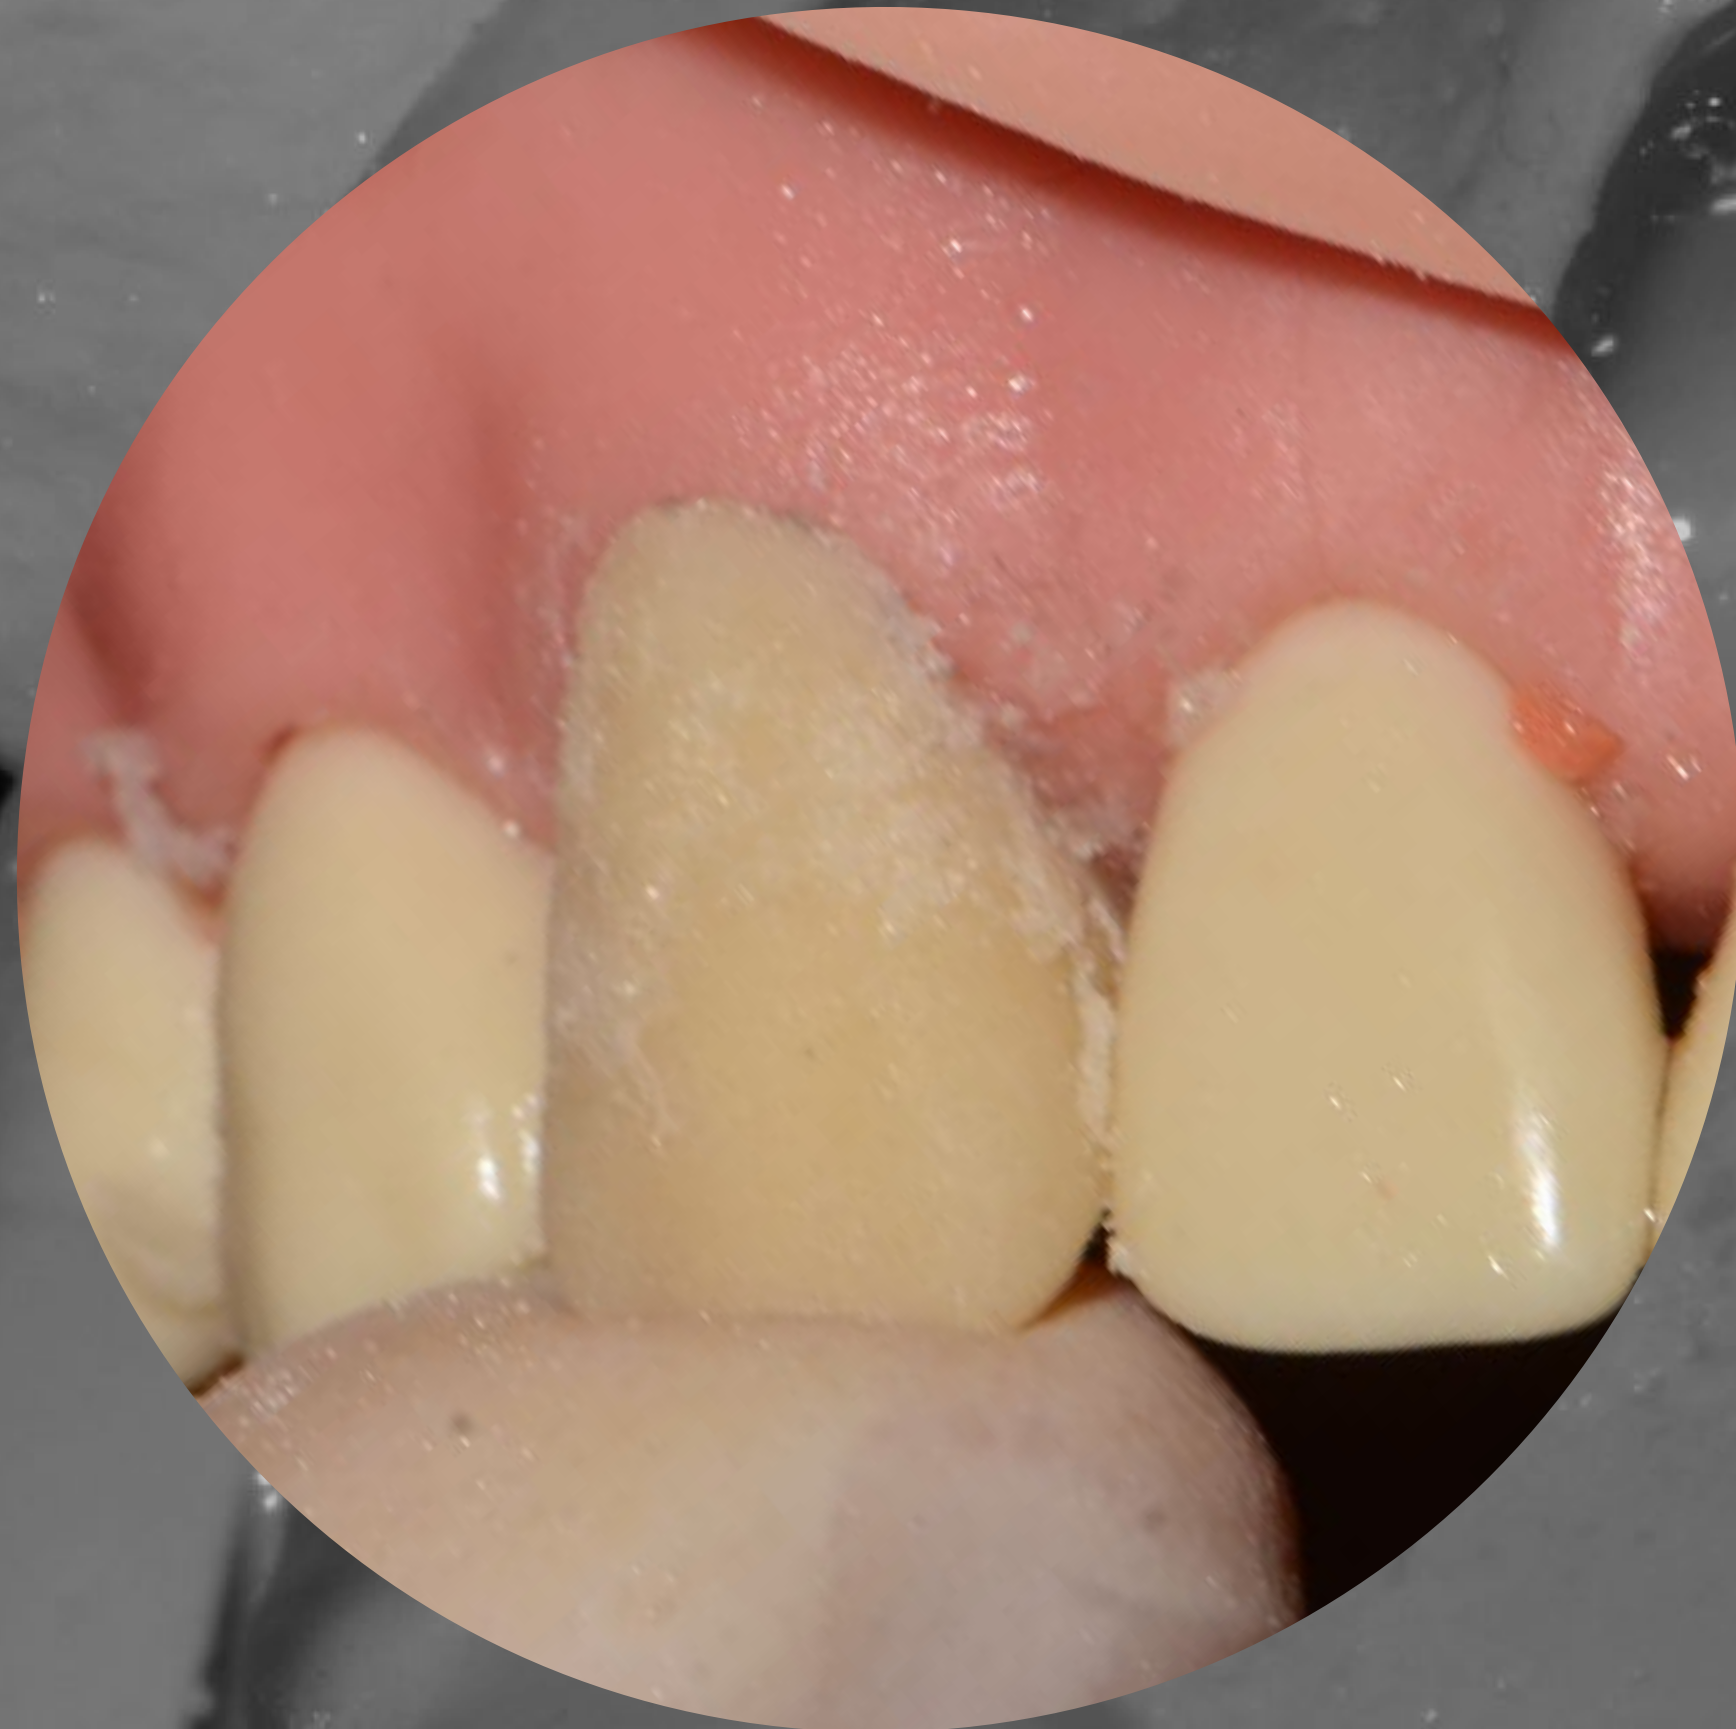




EN CASO DE SER NECESARIO REALICE UN REBASADO DEL ÁREA CERVICAL HASTA LOGRAR UN AJUSTE PERFECTO.





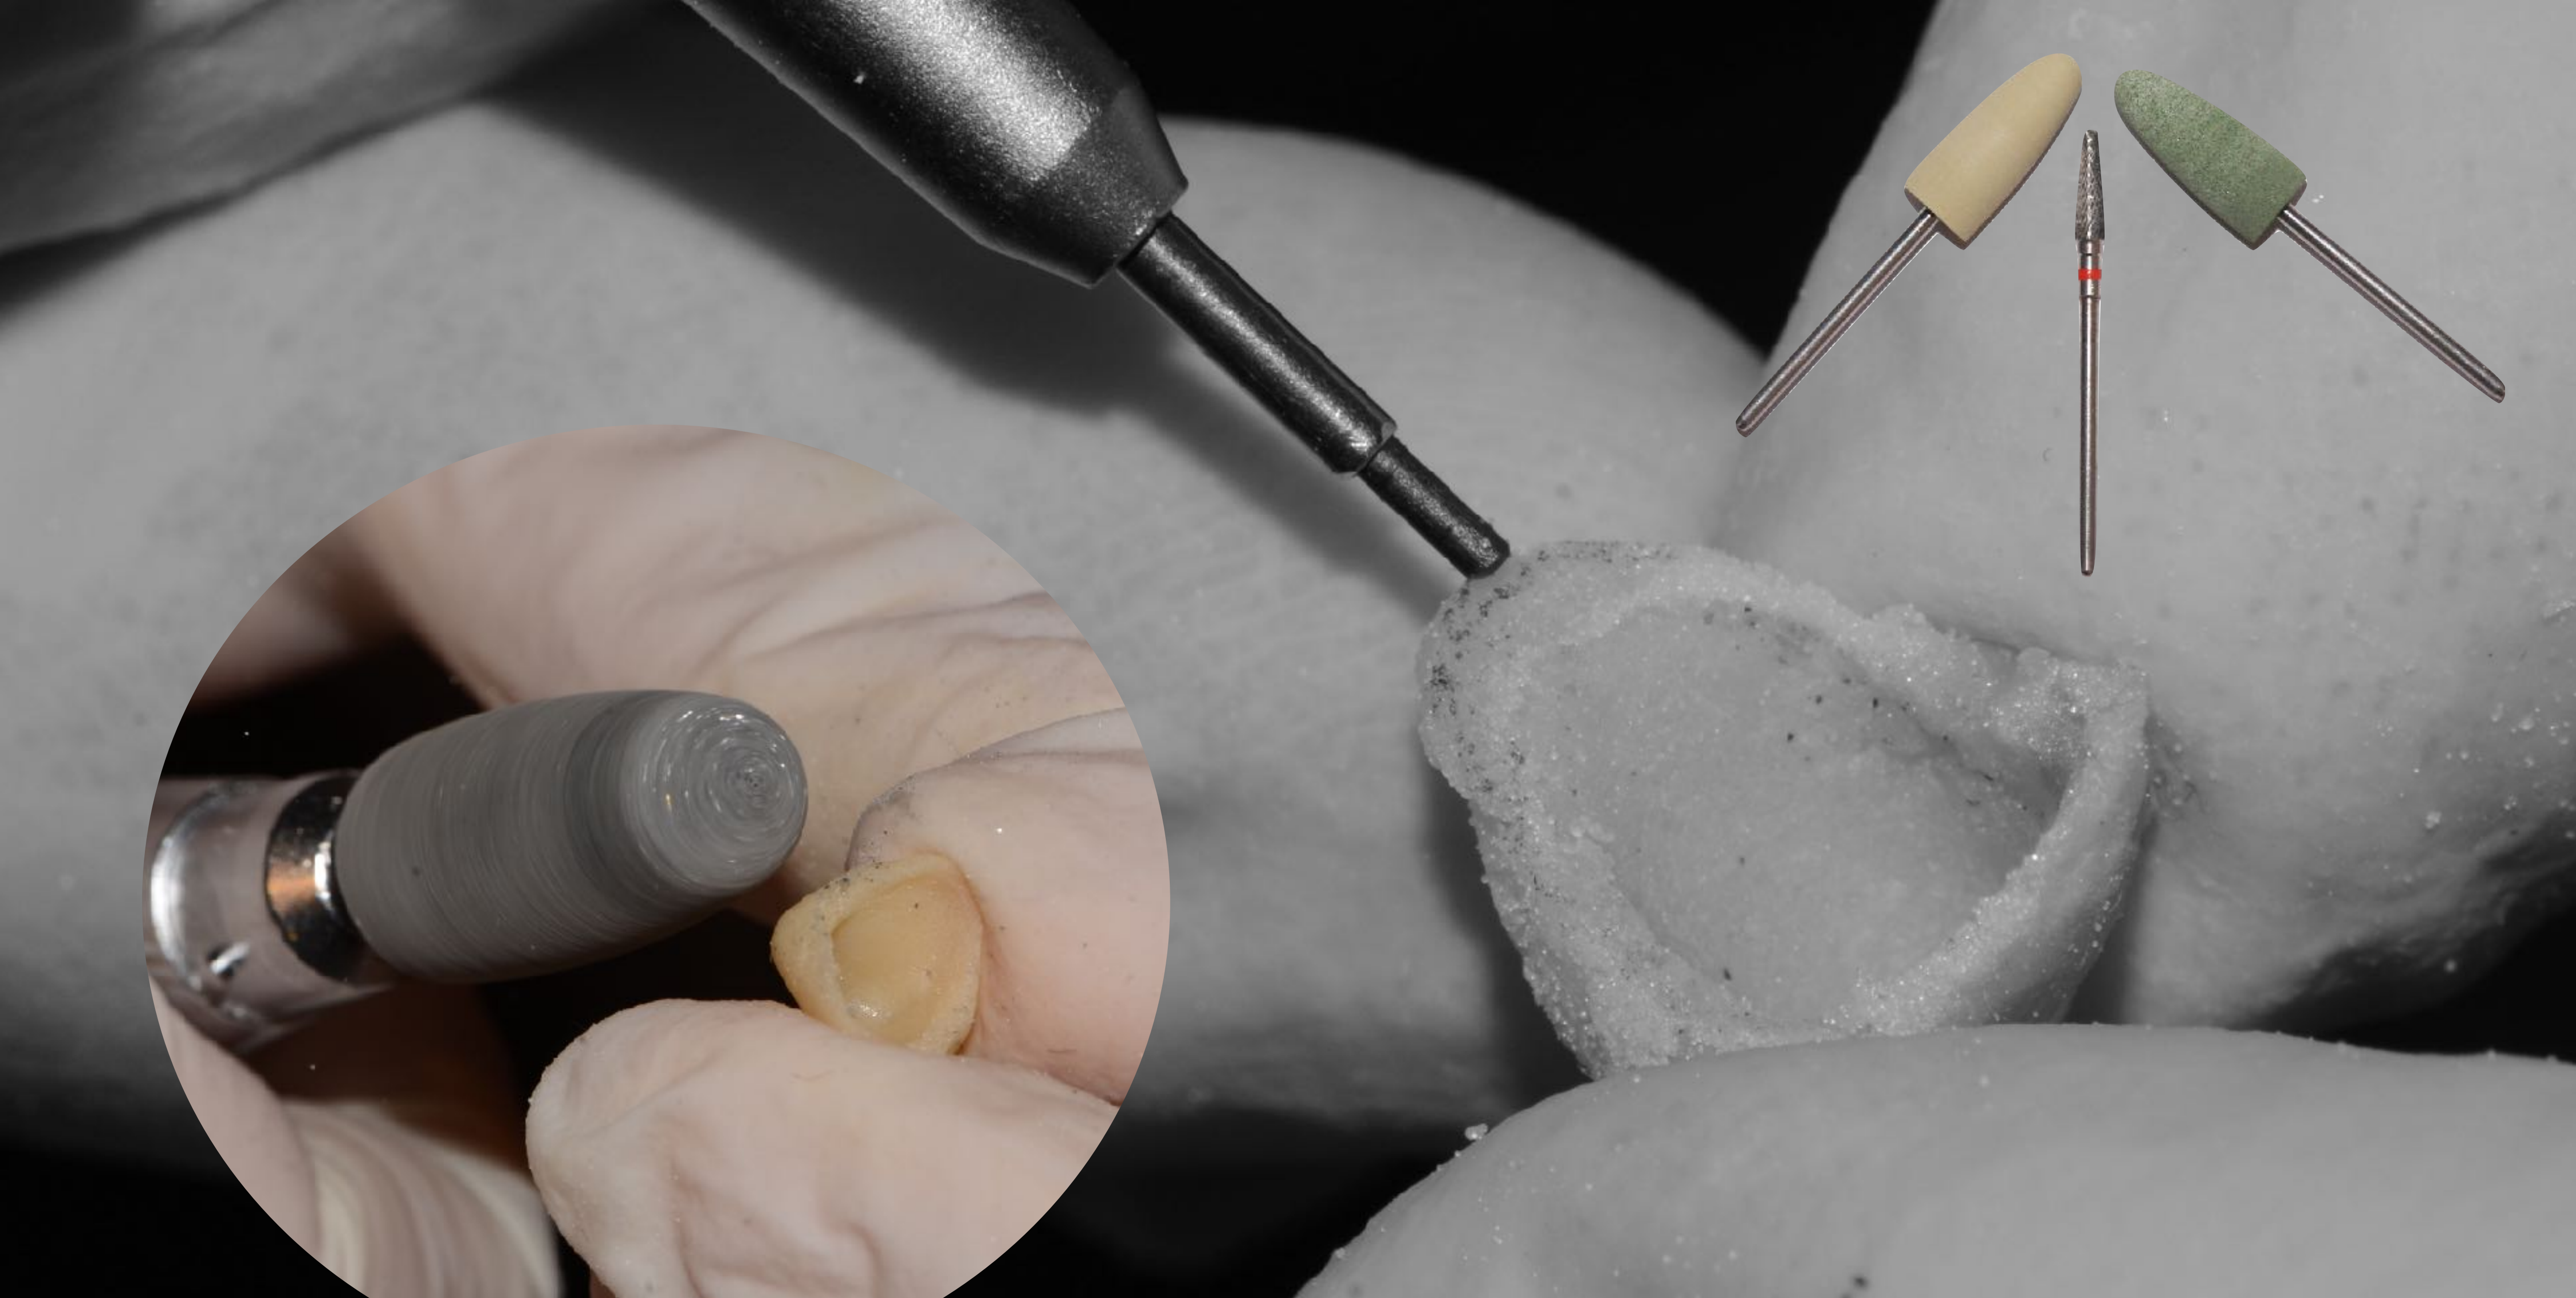

**DELIMITE LA TERMINACIÓN CERVICAL EN EL PROVISORIO CON UN LÁPIZ MINA Y  
ELIMINE LOS EXCESOS CON UN FREGÓN, DISCOS SOLFEO O GOMAS DE PULIR.**



**REALICE UNA CRÍTICA DE SU PROVISORIO EVALUANDO:  
AJUSTE MARGINAL, ANATOMÍA, PUNTOS DE CONTACTO, OCLUSIÓN,  
TERMINACIÓN Y PULIDO.**





CHEQUEO Y AJUSTE DE OCLUSIÓN DEL PROVISORIO CON PAPEL ARTICULAR.





AHORA ESTARÍA LISTO PARA CEMENTAR SU PROVISORIO CON CEMENTO TEMPORAL.





# PRECLÍNICO INTEGRADO



Universidad de  
**los Andes**



**FACULTAD  
DE ODONTOLOGÍA**



**Secuencia de tratamiento:**

**Provisorio de diente 2.1 con técnica híbrida**

*Preclínico Integrado*



Dra. Nicole Schlesinger P.

Dr. Tomas Araya C.

Dr. Gilbert Jorquera R.



MATERIALES NECESARIOS



CE 0197

Kit Preclínico  
Universidad de los Andes  
REF TDXXXX

6801  
314  
012

6801  
314  
014

830L  
314  
010

959KR  
314  
018

368EF  
314  
021

Operatoria

H1  
204  
014

H1  
204  
016

**BRO.DENT**  
www.brodent.cl

6856  
314  
014

6368  
314  
023

8856  
314  
021


Prótesis Fija

859  
314  
010

811  
314  
033





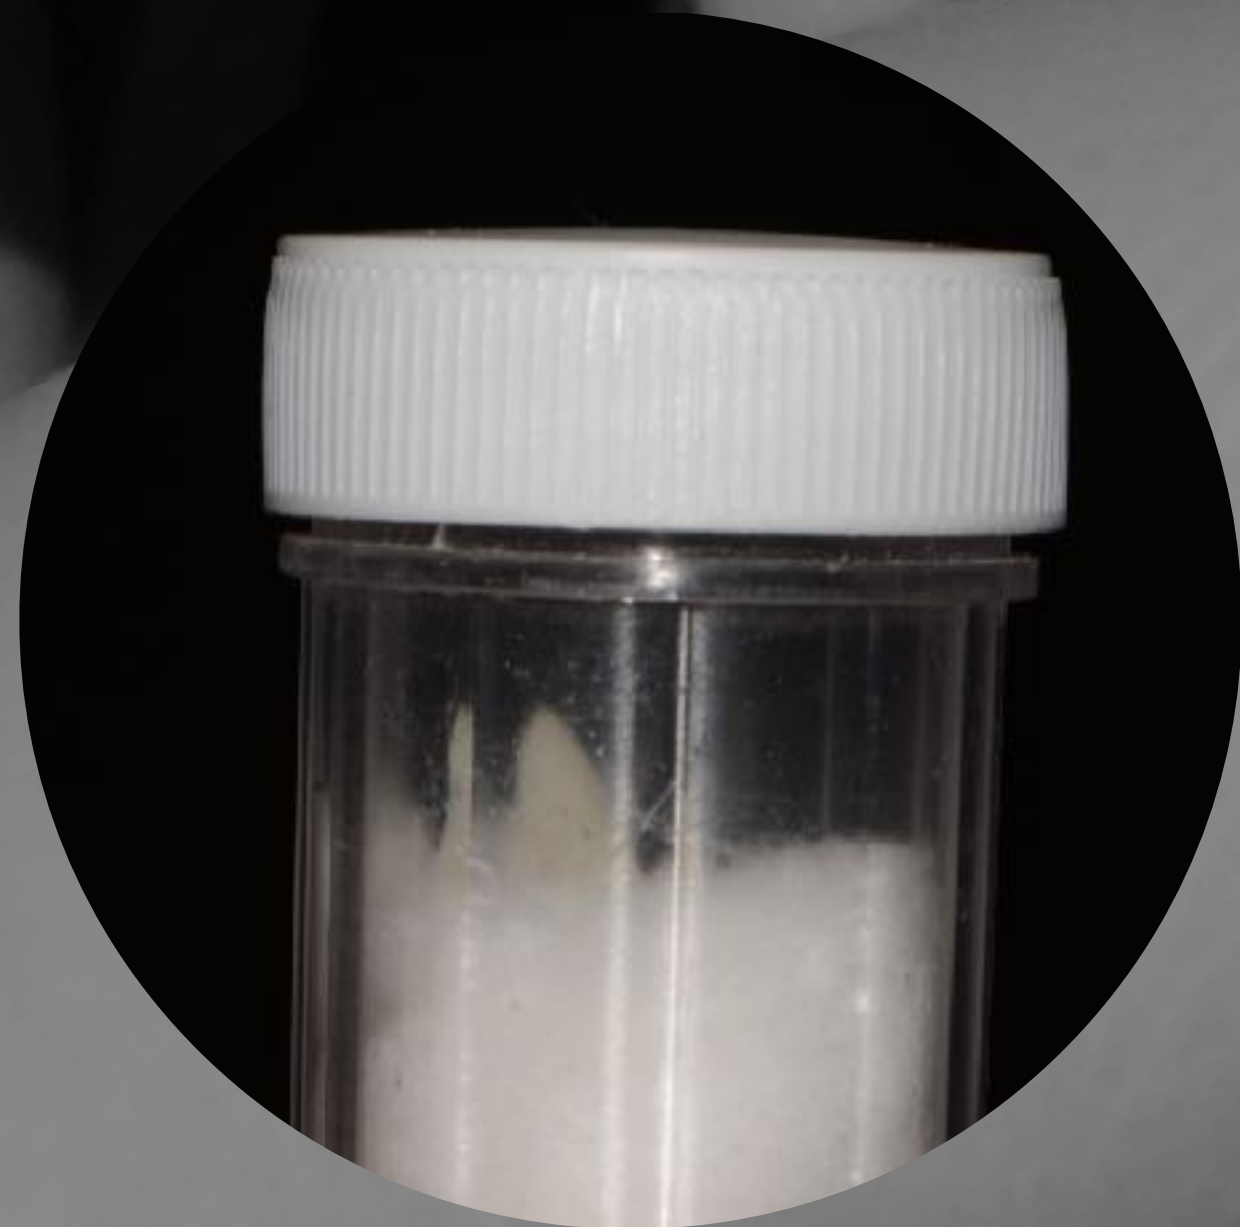

**REVISE EL PROVISORIO QUE  
LLEGÓ DEL LABORATORIO Y  
COMPRUEBE SU AJUSTE  
PASIVO A LA PREPARACIÓN  
BIOLÓGICA.**



**SI EL PROVISORIO NO LLEGA HASTA LA LÍNEA DE TERMINACIÓN SIN SER FORZADO, DEBE DESGASTARLO POR LA ZONA INTERNA CON UNA FRESA CARBIDE DE BAJA VELOCIDAD.**




**UNA VEZ QUE AJUSTE PASIVAMENTE, DEBE APLICAR VASELINA EN LA PREPARACIÓN BIOLÓGICA, PREVIO A REBASAR EL PROVISORIO.**



PREPARE ACRÍLICO  
MARCHÉ DE  
AUTOPOLIMERIZACIÓN  
EN UN VASO DAPPEN.





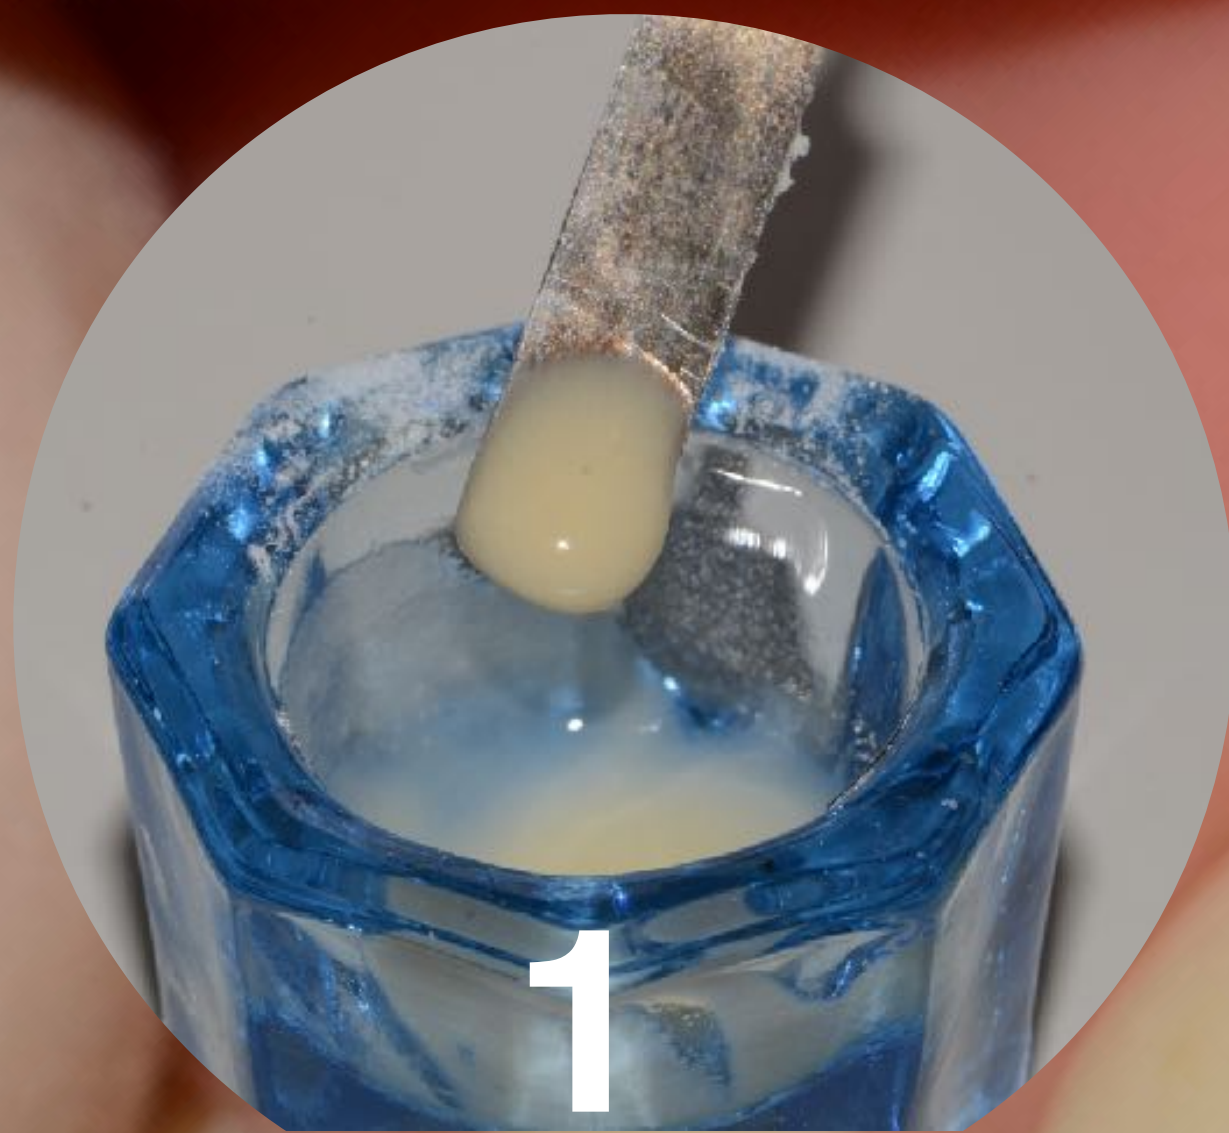

LLEVE EL ACRÍLICO PREPARADO AL INTERIOR DEL PROVISORIO EN ETAPA ARENOSA, Y CUANDO LLEGUE A ETAPA PLÁSTICA, LLÉVELO A POSICIÓN EN RELACIÓN A LA PREPARACIÓN BIOLÓGICA Y ELIMINE LOS EXCESOS CON UNA SONDA.





UNA VEZ FINALIZADA LA POLIMERIZACIÓN DEL ACRÍLICO, MARQUE CON UN LÁPIZ LA LÍNEA DE TERMINACIÓN DE LA PREPARACIÓN EN EL PROVISORIO.



CON FRESONES Y GOMAS DE PULIR ELIMINE LOS EXCESOS, DEJANDO UN  
CORRECTO PERFIL DE EMERGENCIA.





REALICE EL PULIDO DEL PROVISORIO CON DISCOS SOFLEX O GOMAS DE PULIR.








CHEQUEO DE OCLUSIÓN DEL PROVISORIO CON PAPEL ARTICULAR.




# AJUSTE DE OCLUSIÓN DEL PROVISORIO, DESGASTANDO CON FRESONES.

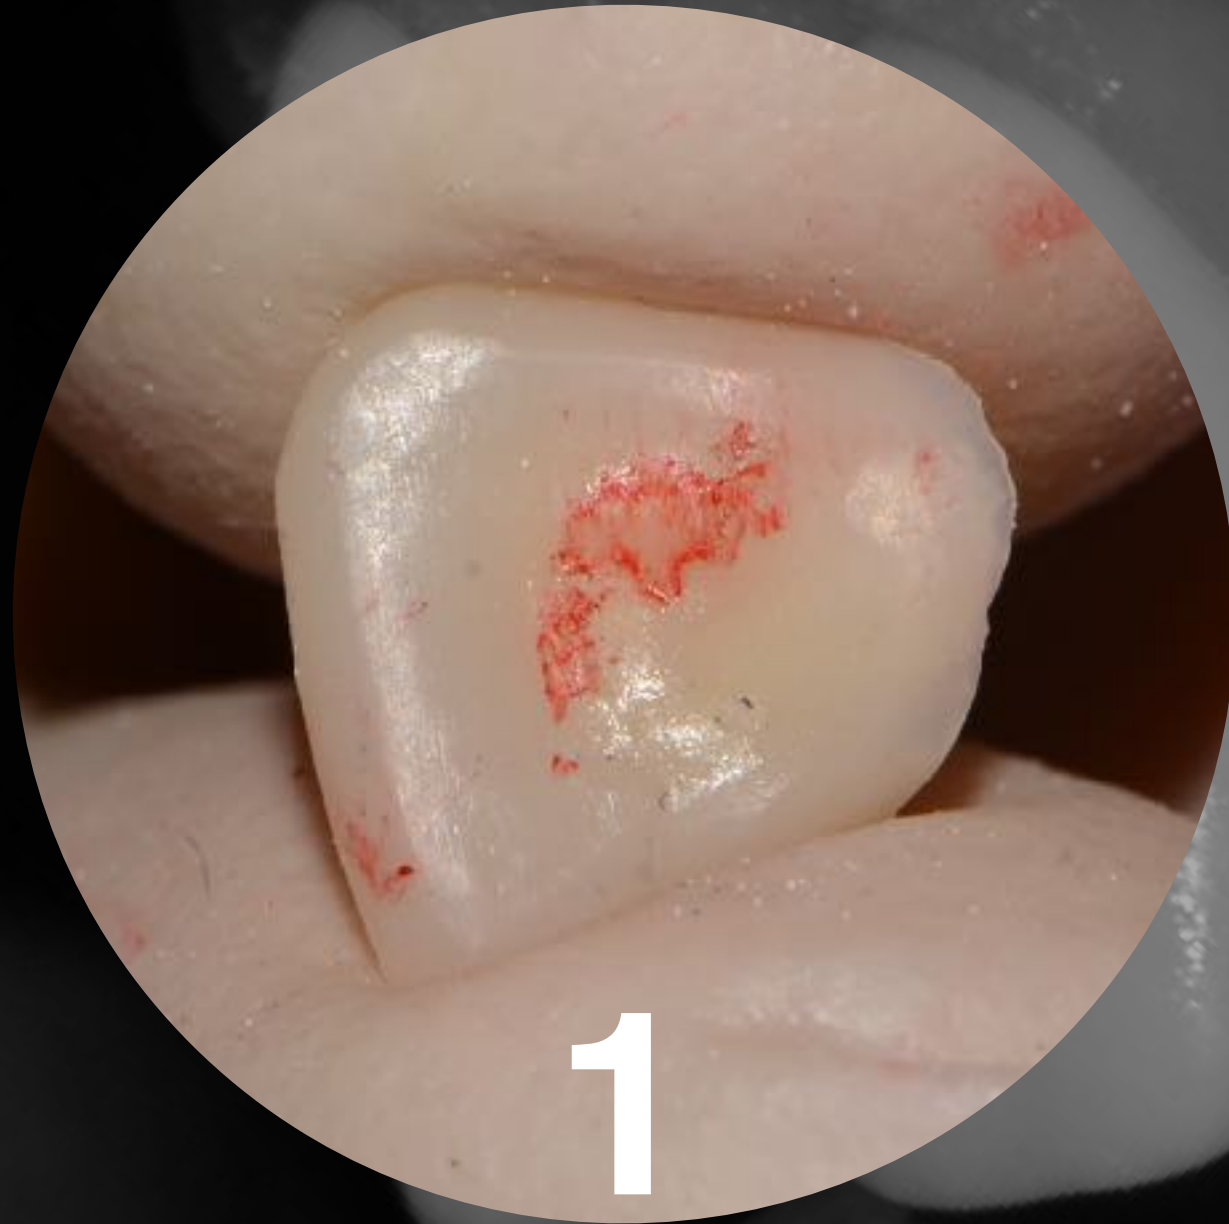





**REALICE UNA CRÍTICA DE SU PROVISORIO EVALUANDO:  
AJUSTE MARGINAL, ANATOMÍA, PUNTOS DE CONTACTO, OCLUSIÓN,  
TERMINACIÓN Y PULIDO.**

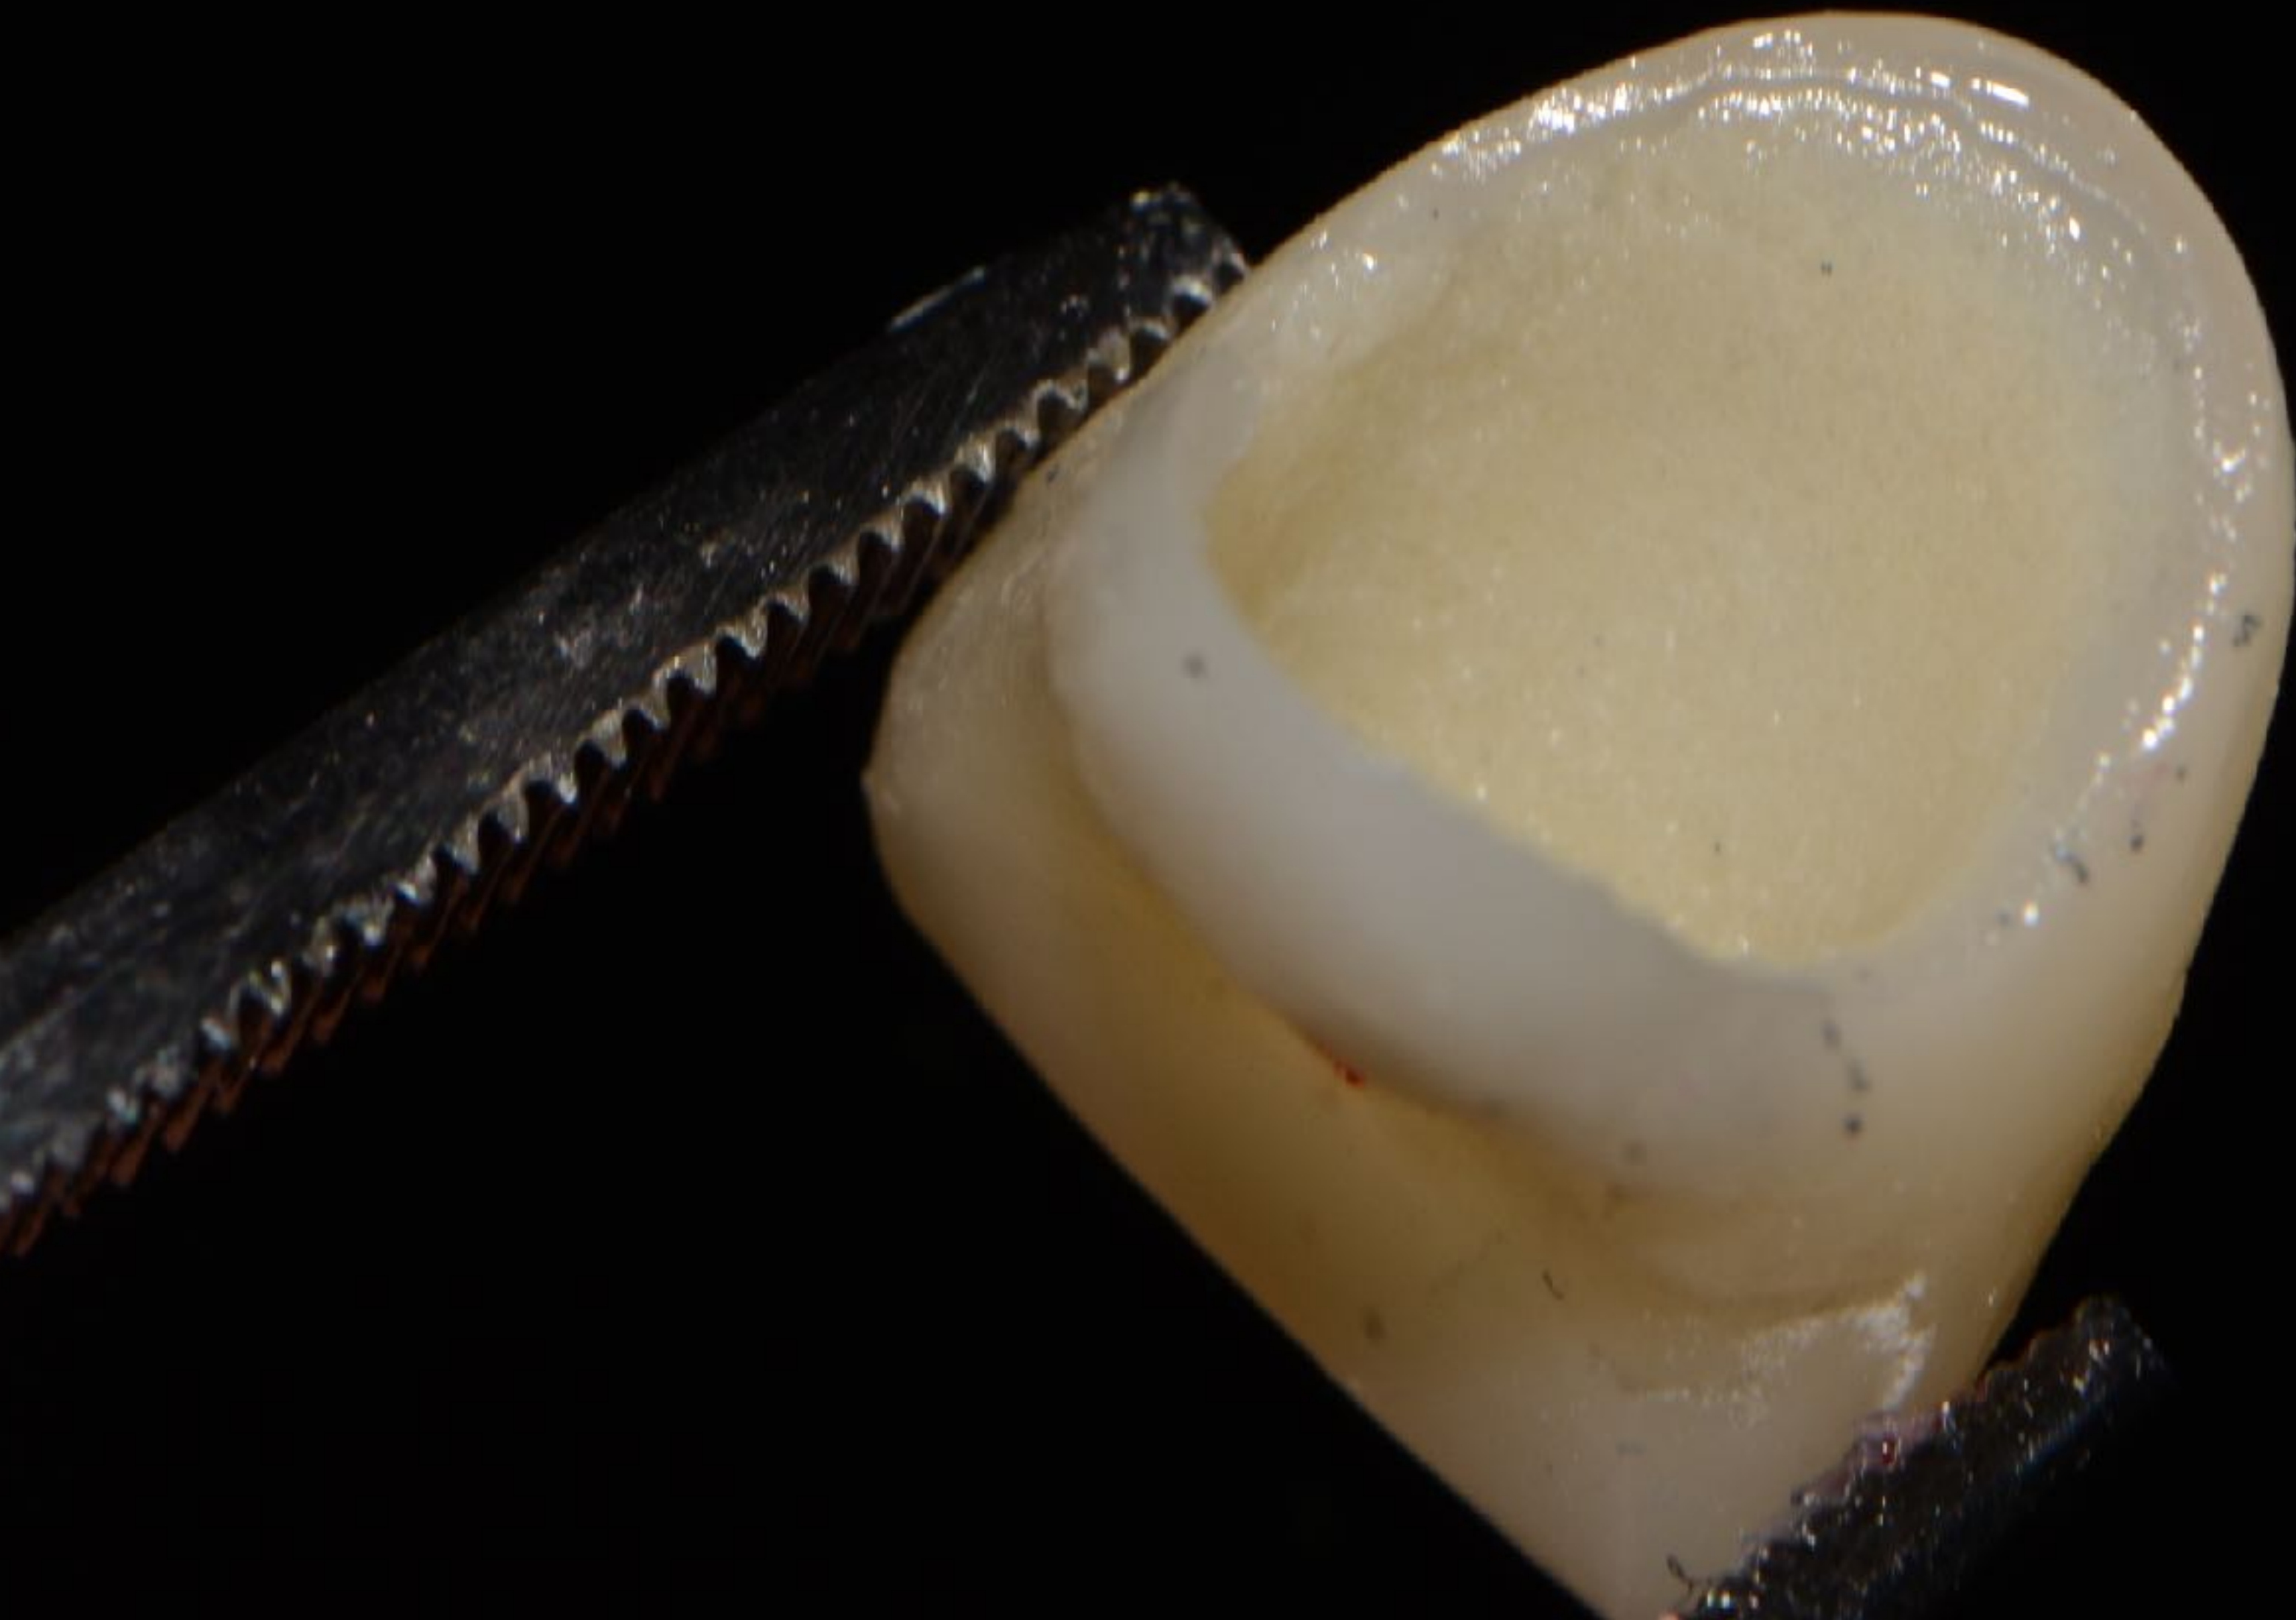




PREPARE CEMENTO TEMPORAL, LLÉVELO AL INTERIOR  
DEL PROVISORIO Y LUEGO CEMENTE ESTE  
ASEGURÁNDOSE DE QUE LLEGUE A POSICIÓN.

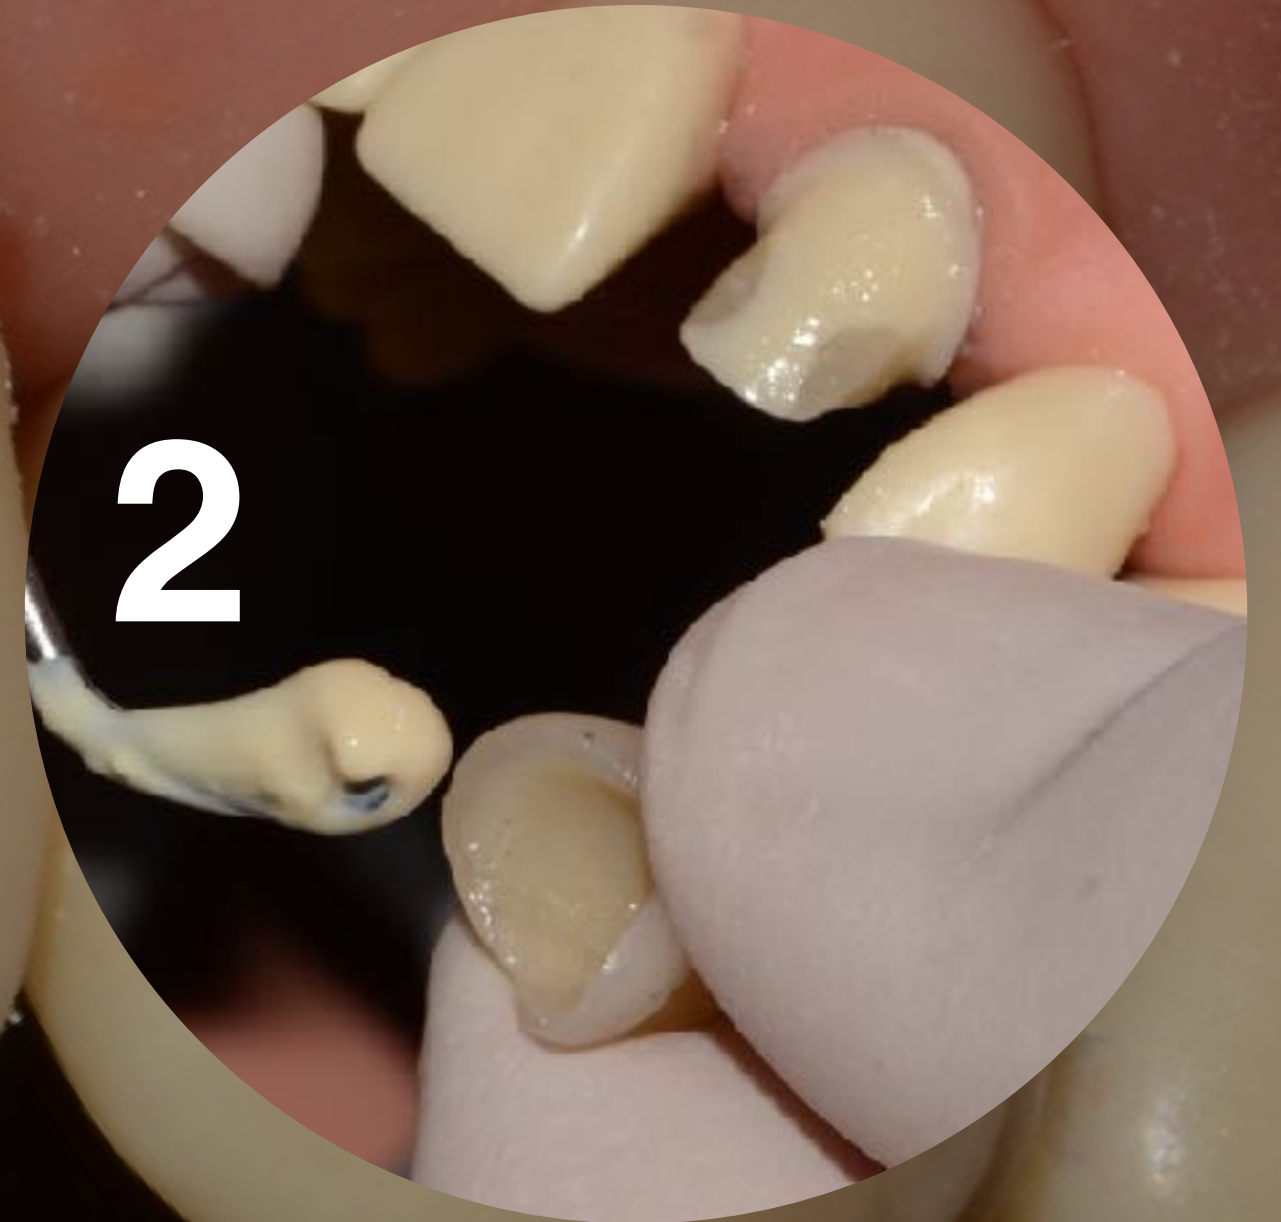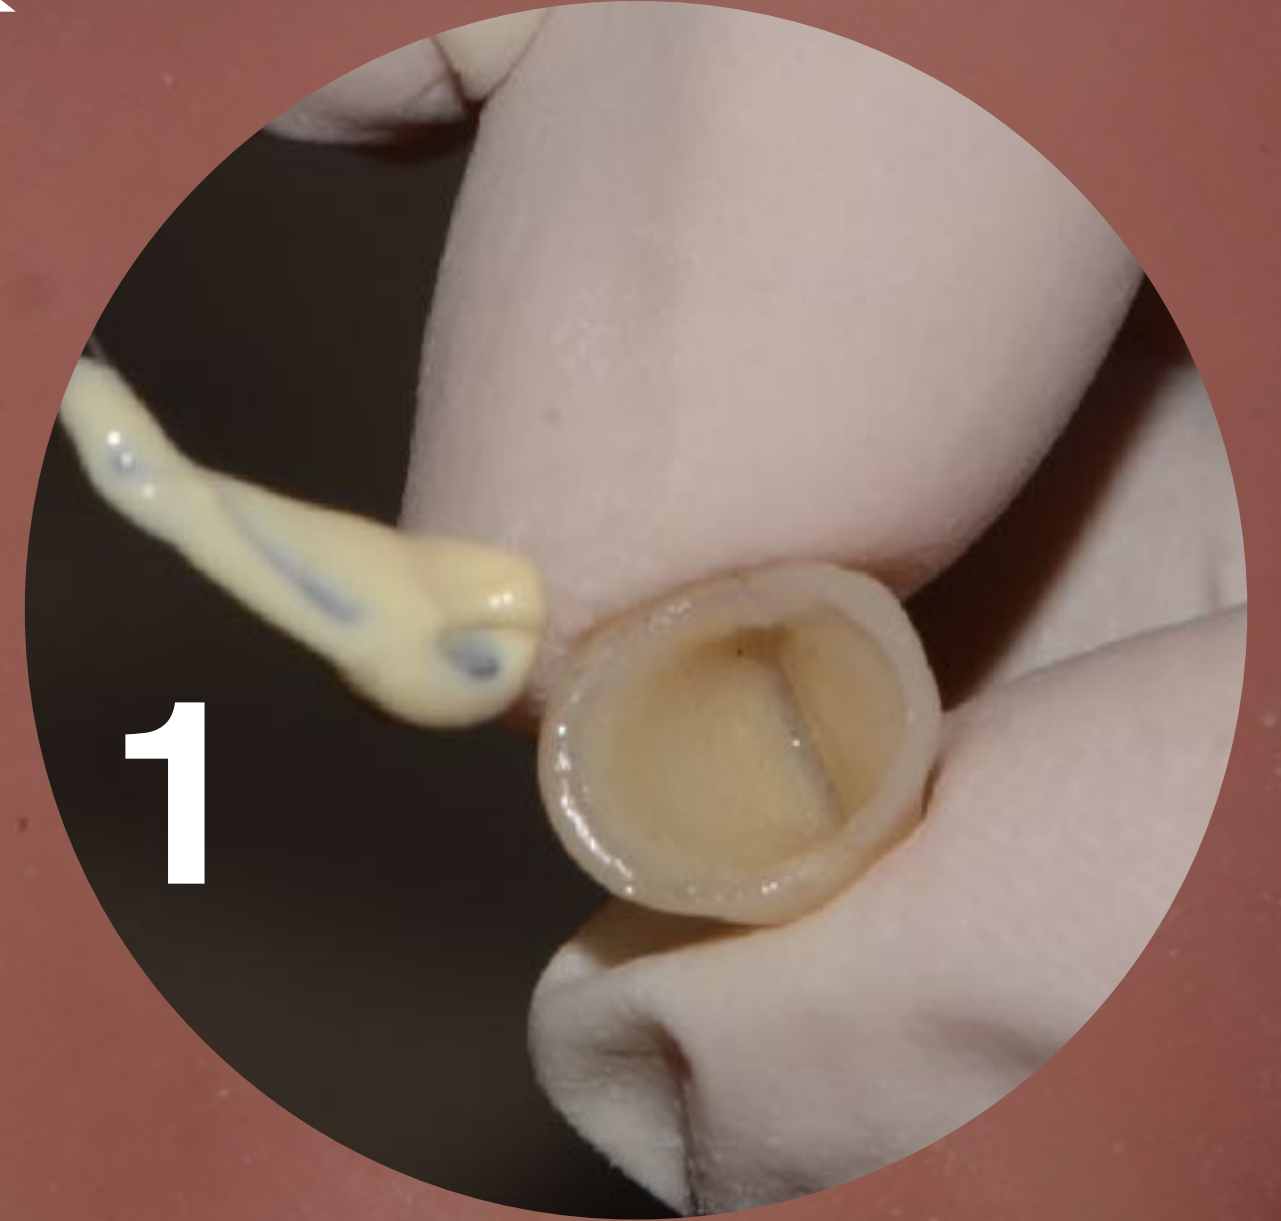



**UNA VEZ FRAGUADO EL CEMENTO TEMPORAL,  
REMUEVA LOS EXCESOS CON UNA SONTA.**

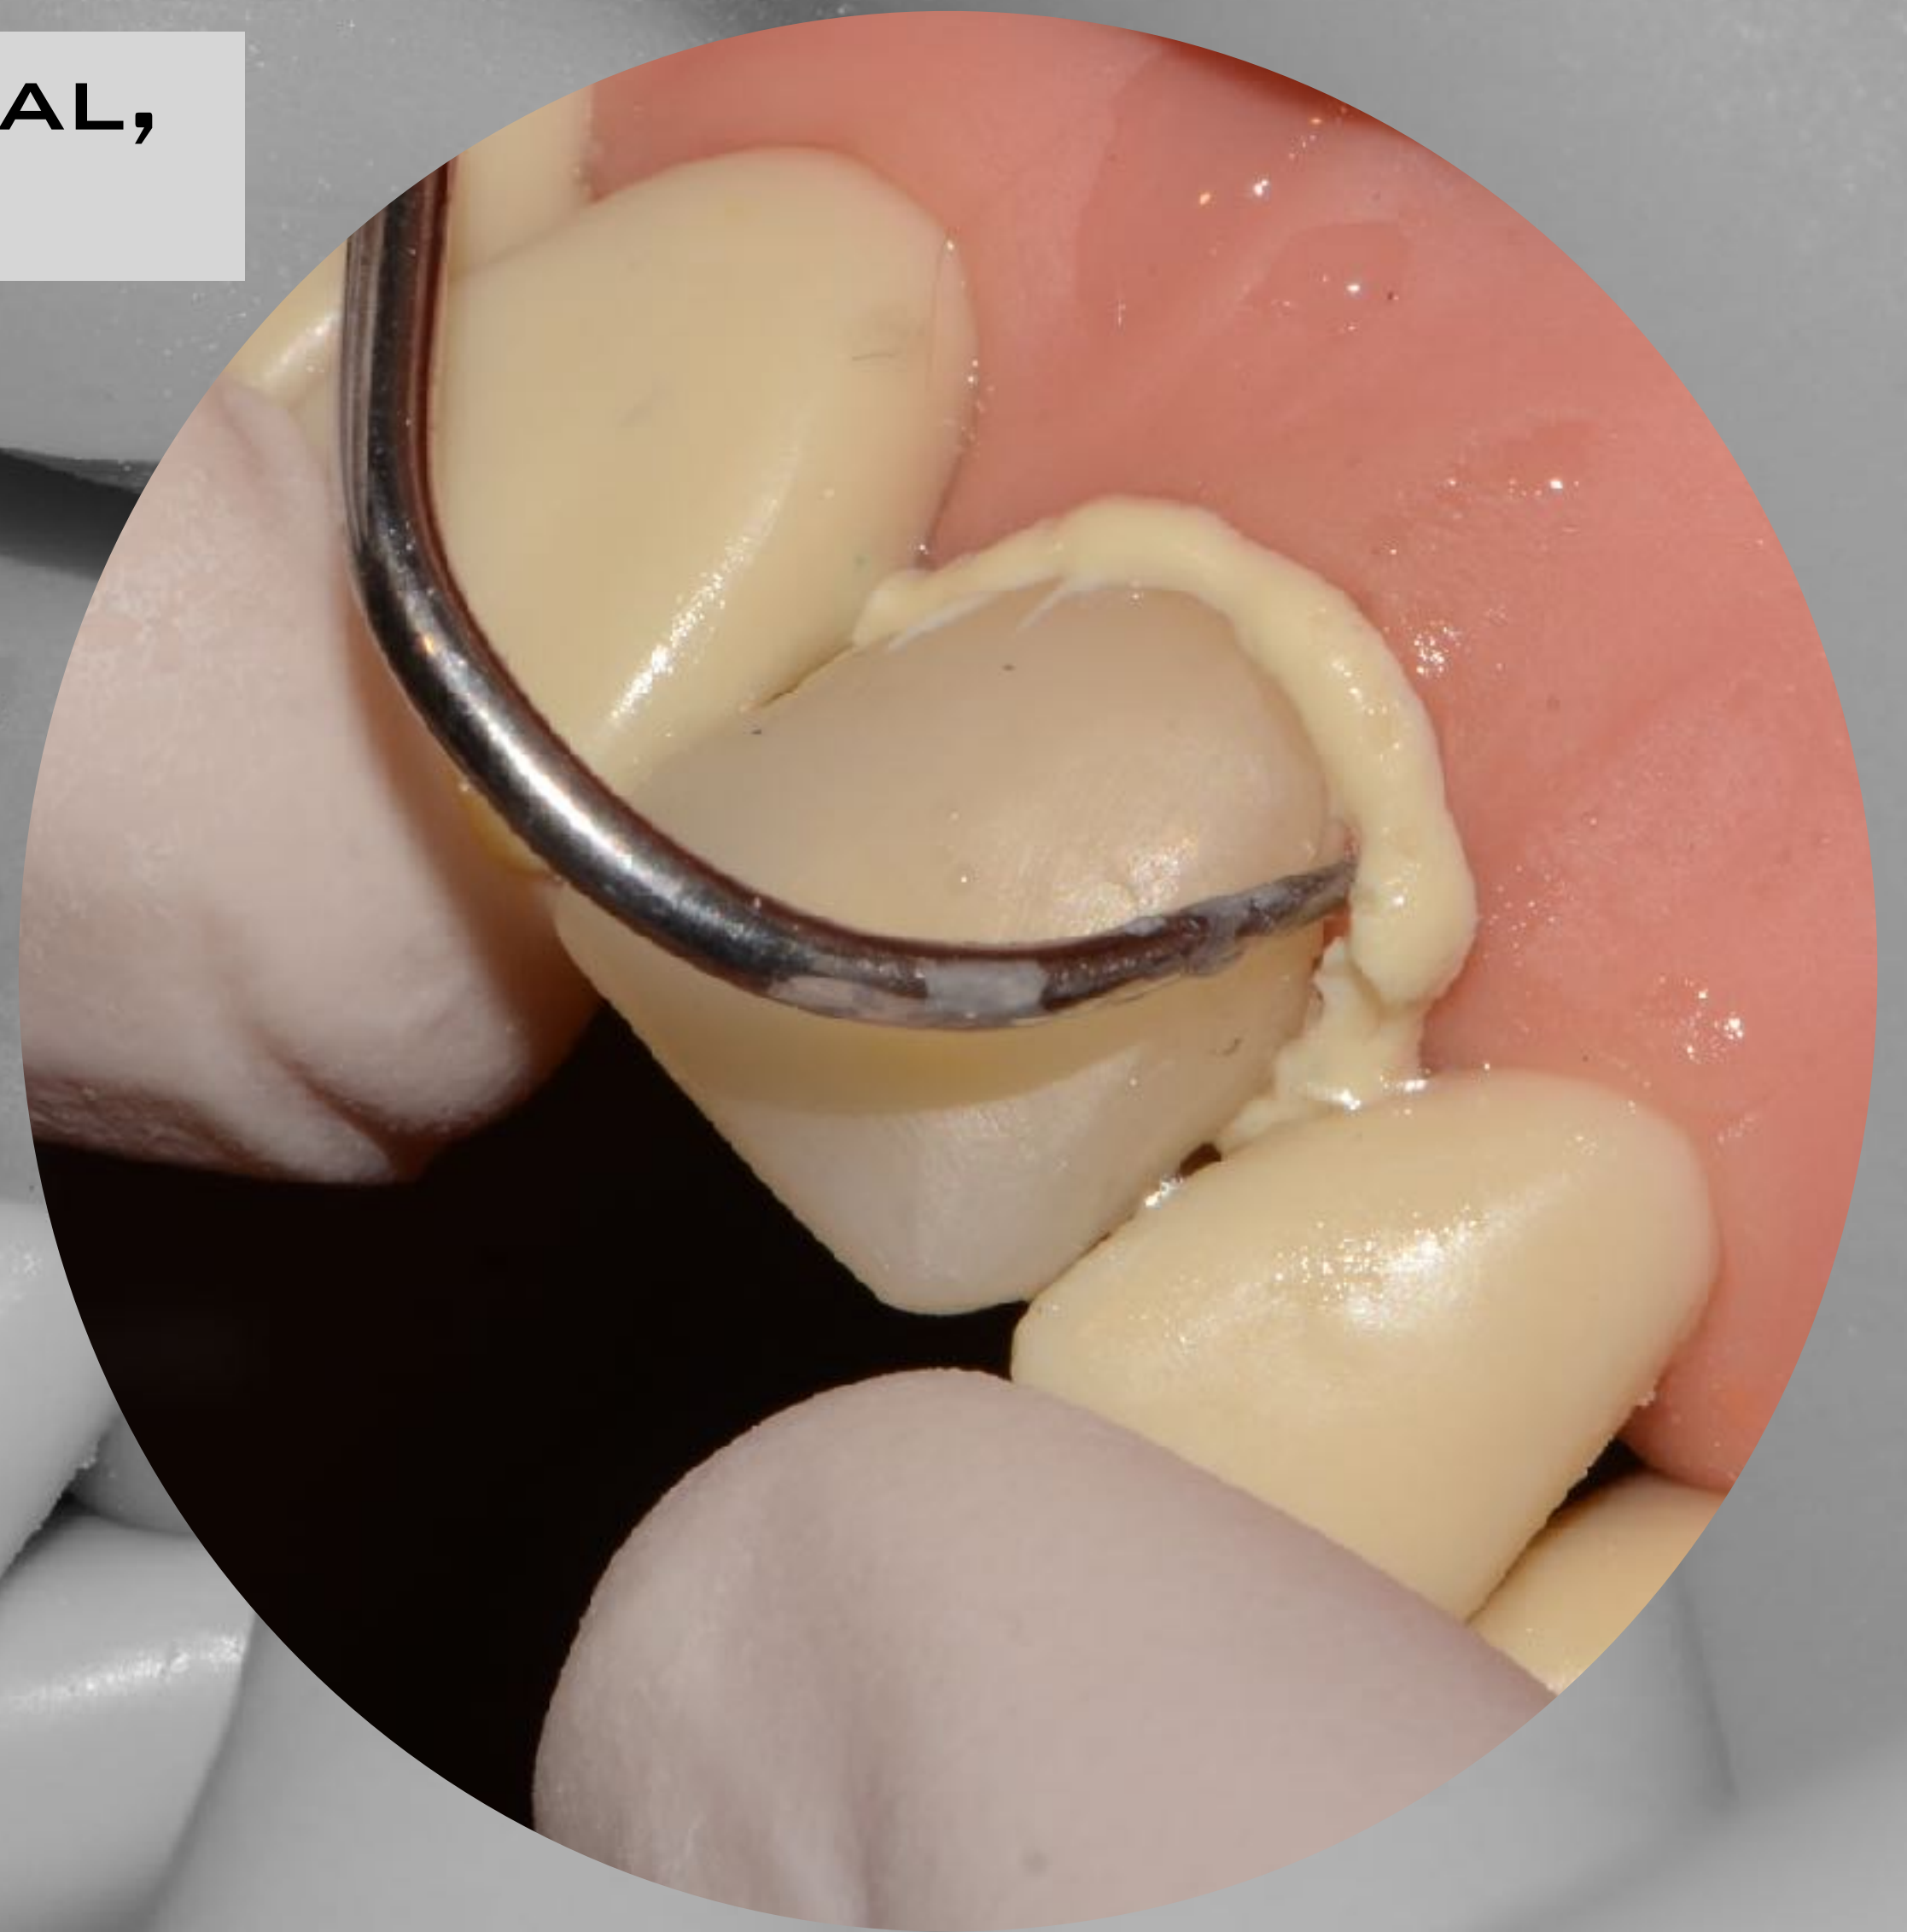







# PRECLÍNICO INTEGRADO



Universidad de  
**los Andes**



**FACULTAD  
DE ODONTOLOGÍA**